

## SDS1002X-E升级指导


**注意: 升级期间，请别切断电源或者拔出U盘。**

**从任意版本升级之后都需要执行自校正。**

1. 升级文件解压缩到U盘。
2. 插入U盘，按下前面板的“Utility”按键。在辅助页面中按“下一页”软键切换到辅助页面第三页。
3. 按下“升级” — “升级固件”，旋转万能旋钮以选中升级文件所在的文件夹。



4. 按下万能旋钮进入到ADS文件所在文件夹，选中所要升级的ADS文件，继续按下软键“按下升级操作”。在固件升级完成之后，窗口提示如下：

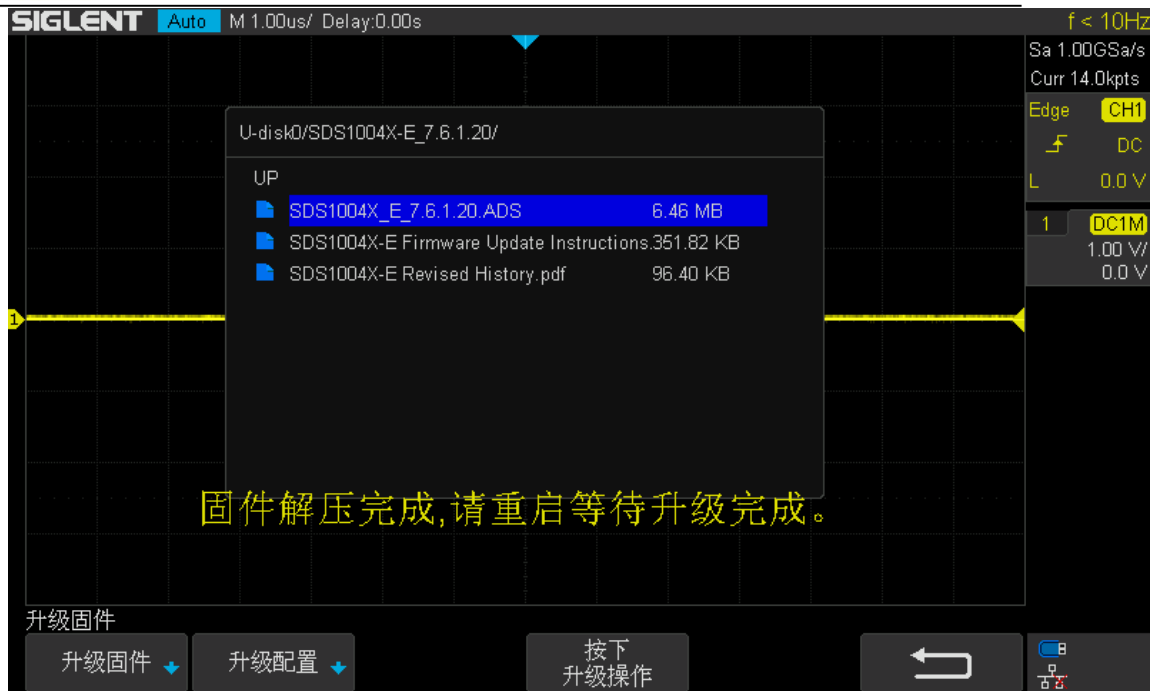

5. 此时重启示波器，示波器升级完成。
6. 重启示波器，点击前面板的“Utility” 按键进入辅助页面，继续点击“自校正” 软键，出现如下窗口，按照窗口提示点击“Single” 按键开始执行自校正。等待几分钟后，按照窗口提示点击“Run/Stop” ，自校正完成。

